

**ERRATA AO EDITAL 005 / 2017**  
**CONVÊNIO: 812346/2014**

O Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória, através do Engenheiro Eletricista / Clínico, torna público para conhecimento dos interessados, que foi realizada correção no Edital 005 / 2017 atendendo a pedido de esclarecimento interposto pela Empresa GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, assim como se segue:


ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO – Pág. 17, Lote 02 – Ventilador Pulmonar.

**Onde se lê:** “Bateria interna com autonomia de pelo menos 120 minutos;” **Leia-se:** “Bateria interna com autonomia de pelo menos 60 minutos;”

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO – Pág. 18, Lote 02 – Ventilador Pulmonar.

**Onde se lê:** “Acessório: 01 (uma) Mangueira de ar comprimido; 01 (uma) Mangueira de O<sup>2</sup>; 01 (um) Braço articulado; 01 (um) Suporte de transposte que possua rodízio e travas; 02 (dois) Circuito pacientes, adulto e pediátrico em silicone (autoclaváveis); 01 Humidificador aquecido; 01 (um) Nebulizador, 01 (um) Conjunto de válvula e sensor expiratórios autoclaváveis.” **Leia-se:** “Acessório: 01 (uma) Mangueira de ar comprimido; 01 (uma) Mangueira de O<sup>2</sup>; 01 (um) Braço articulado; 01 (um) Suporte de transposte que possua rodízio e travas; 02 (dois) Circuito pacientes, adulto e pediátrico em silicone (autoclaváveis); 01 (um) Nebulizador, 01 (um) Conjunto de válvula e sensor expiratórios autoclaváveis.”

Vitória / ES, 03 de Agosto de 2017.

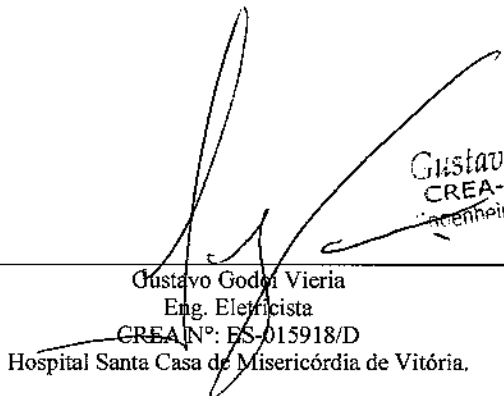

Gustavo Godoi Vieira  
CREA-ES 015918/D  
Engenheiro Clínico do HSCMV

---

Gustavo Godoi Vieira  
Eng. Eletricista  
CREA Nº: ES-015918/D  
Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória.